

一般仕様	
記録デバイス	USBフラッシュメモリー USBハードディスク USB SSD 内蔵ハードディスク (1TB)
ディスプレイ	3.5インチ フルカラーLCD
電源供給	AC 100V～240V 50/60Hz
使用温度範囲	5 ～ 40℃
保存温度範囲	-20 ～ 60℃
使用湿度範囲	5 ～ 80%RH (非結露)
寸法(W×D×H)	約 211 × 235 × 89 mm (ゴム足含む、背面突起物を除く)
質量	約2.6kg
規格	安全 IEC60601-1, CSA60601-1, EN60601-1 EMC IEC60601-1-2, EN60601-1-2, ICES-003, FCC Class B
カテゴリー	FDA Class 1
付属品	電源コード1本、 取扱説明書1部 ※映像ケーブルおよびUSBメモリーなどの記録デバイスは付属していません。
記録フォーマット	
静止画	JPEG
動画	MOV
[動画圧縮方式] [MPEG-4, AVC / H.264]	

純正オプション



リモコン (RC-10)
φ2.5 ミニジャック



フットスイッチ (RC-3F)
φ2.5 ミニジャック

市販品




コンデンサマイク
推奨品: TM-10LB
TASCAM製




USB バーコードリーダー
推奨品:
OPL-6845S-V-WHT-USB
L-46X-V-WHT-USB
(株)オプトエレクトロニクス製



USB カードリーダー
推奨品: CRF-200U-5101-00
(株)ニューロン製



フットスイッチ
φ3.5 ミニジャック
使用可能



USBキーボード



USB ハードディスク



USB SSD



USB メモリー



	安全に関するご注意	■正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 ■水、湿気、湯気、ほこり、所以などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
--	-----------	--

* 仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
* 記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

本製品を用いて映像や音声を記録、またはネットワークを通じて配信する際は、それらのコンテンツにおいて著作権者の承諾が必要な場合があります。著作権保護の観点から、以下の点に留意してください。

- ・本製品で映像や音声を記録する場合、著作権法について十分な理解をしてください。
- ・第三者の著作物である映像や音声素材を権利者の許可なく公開や配信をすること、および本製品で記録した内容をネットワークの共有状態にすることは法的に禁止されています。
- ・本製品を用いて記録した映像や音声は個人的に使用するなどの他は著作権法により権利者の許可なしに使用することはできません。弊社ではお客様による権利侵害行為については一切の責任を負いません。
なお、実演や興行、展示物、学会での発表などは、個人的な目的であっても撮影、記録が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- ・ソフトウェアのバージョンアップや機能拡張に伴い、著作権保護を目的として本製品で記録可能な映像や音声信号の仕様は予告なく変更されることがあります。

記録内容に関する免責事項： 本製品の不具合や故障により記録ができなかった場合や、何らかの原因で記録内容が損傷・消失した場合など、いかなる状況でも、当社は記録内容の補償やそれに伴う損害について責任を負いません。
また、記録内容の修復や復元、複製などはい行いませんので、あらかじめご了承ください。

TEAC

ティアック株式会社

情報機器事業部 イメージングシステムソリューション営業部 メディカルシステム営業課
〒206-8530 東京都多摩市落合1-47 TEL. 042-356-9160 FAX. 042-356-9185 <http://teacmv.jp/>
このカタログの記載内容は2025年5月現在のものです。

PRINTED IN JAPAN 0525・ISD-252B

TEAC

メディカルビデオレコーダー
UR-4MD-SE

医用画像の録画・管理に 今までにない使いやすさを






長時間記録



直感的な操作



映像信号自動認識



DIGITAL
ANALOG
640 x 480 ~ 1920 x 1200
幅広い入力解像度



音声記録*



外部USBデバイス



ネットワーク転送



最大4箇所
同時記録

* マイク入力またはライン入力が必要です




源流であるUR-4MDは、10年にわたり手術映像記録向けメディカルビデオレコーダーとして医療現場への提供を続けてきました。これまでにいただいた現場の意見を取り入れて培った機能や操作性を活かし、このたび『UR-4MD-SE』として新たに生まれ変わりました。

ティアックは、今後も医療現場の皆様から信頼される製品を提供してまいります。

標準機能となったネットワーク転送

ネットワーク自動転送機能を使って院内の端末で画像データを共有することができます。

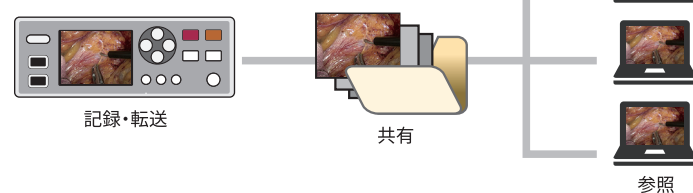

SD画質からHD画質まで幅広い対応解像度

640×480～1920×1200*までの入力解像度の映像を自動的に認識します。*1920×1200入力時の記録解像度は1728×1080になります。




医療現場に特化した操作性

直感的に操作可能なフロントパネルデザインを採用し、初めて扱う方でも迷いなく動画、静止画が記録できます。



音声記録

動画内に音声を記録でき、手技説明や手術内容の説明に活用できます。 ※マイク入力またはライン入力が必要です。

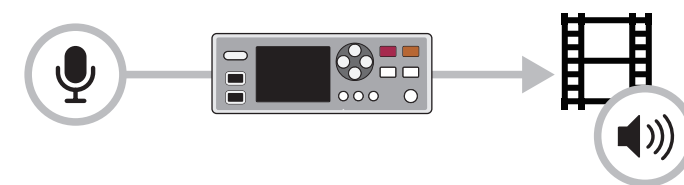

患者情報の入力

バーコードリーダーやキーボード、カードリーダーを接続し、患者情報を入力することができます。

※半角英数字に対応



記録可能時間


HD (High Definition) 1920 x 1080					SD (Standard Definition) 720 x 480				
ビットレート (目安)	LQ (12Mbps) (音声無し)	EQ (12Mbps)	SQ (18Mbps)	HQ (24Mbps)	ビットレート (目安)	LQ (2Mbps) (音声無し)	EQ (5Mbps)	SQ (8Mbps)	HQ (10Mbps)
1時間の記録容量 (目安)	約5.0 GB	約5.4GB	約8.1 GB	約10.8 GB	1時間の記録容量 (目安)	約0.9 GB	約2.3 GB	約3.6 GB	約4.5 GB
内蔵 HDD (1TB)	約200 時間	約180 時間	約120 時間	約 90 時間	内蔵 HDD (1TB)	約1,100 時間	約360 時間	約270 時間	約200 時間
外部 デバイス (2TB)	約400 時間	約360 時間	約240 時間	約180 時間	外部 デバイス (2TB)	約2,200 時間	約720 時間	約540 時間	約400 時間

※記録時間は映像により変動します。※LQモード時は音声は記録されません。

多彩な映像端子を自動認識

HD画質：3G-SDI / HD-SDI / DVI-D

SD画質：SD-SDI / S-Video / Composite

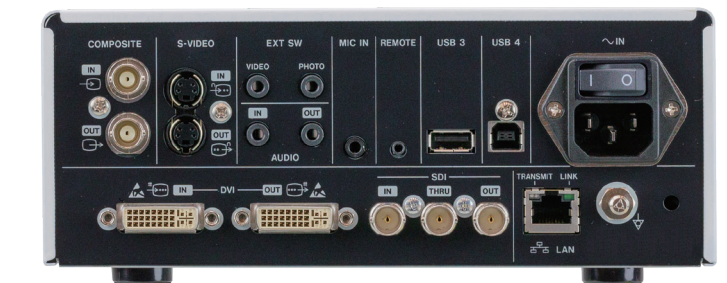

※3G-SDI / HD-SDI / DVI-D / SD-SDI と S-Video / Composite の相互出力はできません。
※SDI は入力された解像度で映像出力されます。

長時間動画記録の保存


内蔵HDDが1TBとなり、HD画質で最長で約200時間まで保存可能です。

※内蔵HDDが一杯になった際には記録不可となります。設定により電源起動時に一定の空き容量を確保します。

万ーのためのデータバックアップ

最大4箇所への同時記録が可能です。

※動作検証済 記録用USBデバイスについては、当社ホームページをご確認ください。

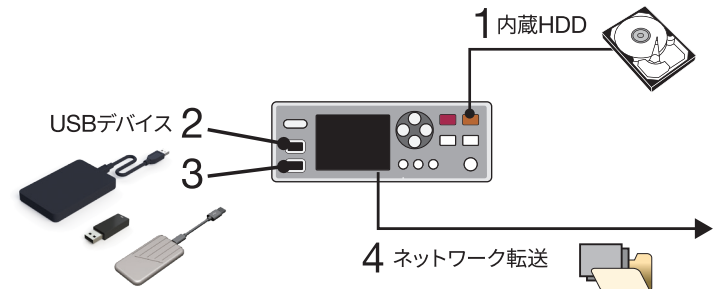

システム構成図

